

# TPLO & CBLO Titanium Plate System Line Up

## TPLO Titanium Plate

TPLO プレート  
医療機器製造販売承認番号：27 動薬第 2596 号

TPLO チタンプレート



\* ノンロッキング


商品コード	商品名	Left/Right	全長	幅1	幅2	厚み	穴径
TPLO-20L6	TPLOチタンプレートφ2.0	Left	27.5	9.8	5.0	2.0	2.5
TPLO-20R6	TPLOチタンプレートφ2.0	Right					
TPLO-24L6	TPLOチタンプレートφ2.4	Left	35.5	13.5	7.0	2.8	2.8
TPLO-24R6	TPLOチタンプレートφ2.4	Right					
TPLO-27L6	TPLOチタンプレートφ2.7	Left	42.0	17.2	9.0	3.7	3.2
TPLO-27R6	TPLOチタンプレートφ2.7	Right					

材質：JIS2種 純チタン

## CBLO Titanium Plate

TPLO プレート  
医療機器製造販売承認番号：27 動薬第 2596 号

CBLO チタンプレート

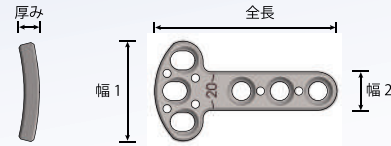

\* ノンロッキング

商品コード	商品名	全長	幅1	幅2	厚み	穴径
CBLO-20LR	CBLOチタンプレートφ2.0	23.8	13.0	5.0	2.0	2.5
CBLO-24LR	CBLOチタンプレートφ2.4	30.0	18.4	7.0	2.8	2.8
CBLO-27LR	CBLOチタンプレートφ2.7	35.5	21.0	9.0	3.7	3.2
CBLO-35LR	CBLOチタンプレートφ3.5	52.8	27.0	11.5	5.6	4.5

材質：JIS2種 純チタン

## Screw Line Up

ST 動物用チタンスクリュー：医療機器製造販売承認番号 27 動薬第 2965 号

コーテックススクリュー

キャンセラススクリュー

商品コード	全長	Cortex Screw φ2.0		Cortex Screw φ2.4		Cortex Screw φ2.7		Cortex Screw φ3.5	
		商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長	商品コード	全長
CR20-04T	4	CR20-06T	6	CR27-10T	10	CR35-20T	20		
CR20-06T	6	CR24-08T	8	CR27-12T	12	CR35-22T	22		
CR20-08T	8	CR24-10T	10	CR27-14T	14	CR35-24T	24		
CR20-10T	10	CR24-12T	12	CR27-16T	16	CR35-26T	26		
CR20-12T	12	CR24-14T	14	CR27-18T	18	CR35-28T	28		
CR20-14T	14	CR24-16T	16	CR27-20T	20	CR35-30T	30		
CR20-16T	16	CR24-18T	18	CR27-22T	22	CR35-32T	32		
CR20-18T	18	CR24-20T	20	CR27-24T	24	CR35-34T	34		
CR20-20T	20	CR24-22T	22	CR27-26T	26	CR35-36T	36		
CR20-22T	22	CR24-24T	24	CR27-28T	28	CR35-38T	38		
CR20-24T	24			CR27-30T	30	CR35-40T	40		
				CR27-32T	32				


商品コード	全長	Cancellous Screw φ2.4		Cancellous Screw φ2.7	
		商品コード	全長	商品コード	全長
CS24-06T	6	CS24-08T	8	CS24-10T	10
CS24-08T	8	CS24-10T	10	CS24-12T	12
CS24-10T	10	CS24-12T	12	CS24-14T	14
CS24-12T	12	CS24-14T	14	CS24-16T	16
CS24-14T	14	CS24-16T	16	CS24-18T	18
CS24-16T	16	CS24-18T	18	CS24-20T	20
CS24-18T	18	CS24-20T	20	CS24-22T	22
CS24-20T	20	CS24-22T	22		
CS24-22T	22				
CS24-24T	24				

材質：チタン合金

## Sophia Crescent Blade

製造販売元：株式会社デンテック 動物用一般医療機器

ソフィアクレセントプレート

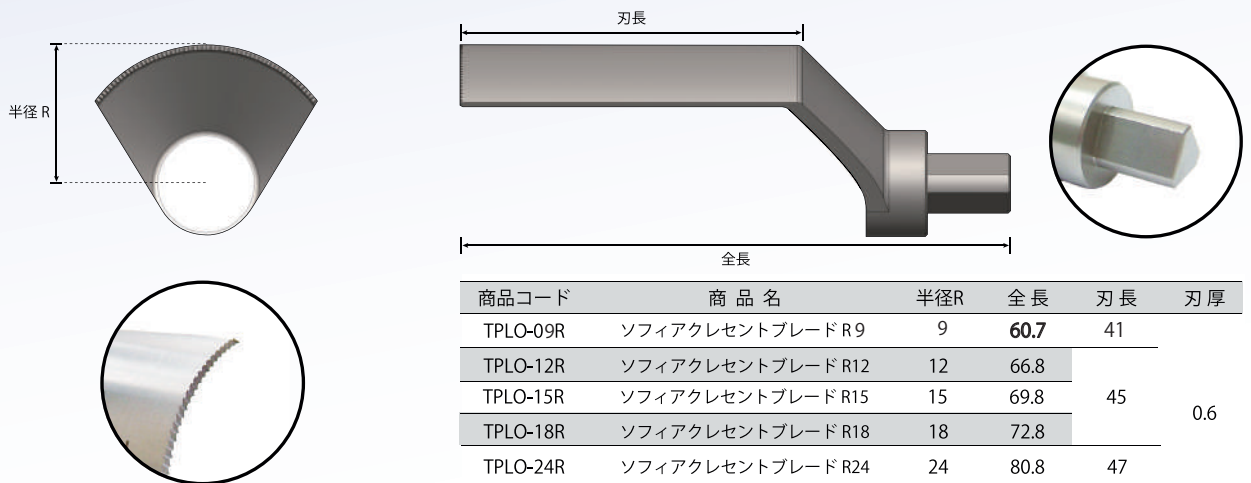

商品コード	商品名	半径R	全長	刃長	刃厚
TPLO-09R	ソフィアクレセントプレート R9	9	60.7	41	0.6
TPLO-12R	ソフィアクレセントプレート R12	12	66.8		
TPLO-15R	ソフィアクレセントプレート R15	15	69.8	45	
TPLO-18R	ソフィアクレセントプレート R18	18	72.8		
TPLO-24R	ソフィアクレセントプレート R24	24	80.8	47	

材質：ステンレス

\* 表示単位：mm

- 使用上の注意
- 本製品は、他メーカーのインプラント、原材料の異なるインプラントとは併用しないこと。本製品は専用のスクリュー（ST 動物用チタンスクリュー）を使用すること。
  - 異種金属が相互に触れ合うと電気化学的腐食反応が生じ、不具合が生じる危険性が高まる恐れがあるため、材質の異なるインプラントとは併用しないこと。
  - スクリュー固定の際、骨質によっては、タッピングを併用すること。
  - 術後、完治するまでは外固定を併用すること。
  - 本製品を使用した患畜には、注意深く術後管理を行なうこと。
  - 肥満体の患畜には慎重に使用すること。（患畜の体重によるインプラントへの負担の為、骨固定の失敗やインプラント材料の変形や破損による不具合発現の可能性がある）

販売元



株式会社プラトンジャパン  
〒195-0062 東京都町田市大蔵町 56

【お問合せ受付】 平日9:00～17:00迄  
TEL: 042-736-3903  
FAX: 042-735-2426  
E-mail: info@sophiatech.co.jp

代理店